

- ① 打开电源, 即可开始测量
- ② 手机扫码设备上 4G 二维码或者电脑端输入 4G 序列号, 即可完成 4G 通讯连接, 测量数据可在云平台进行查看

**注意!**

01. 在对压缩气体进行测量时, 请避免人员接触产品带压部分
02. 产品无防爆功能, 禁止在有防爆要求的场所使用
03. 违规操作造成的任何后果制造商不予承担

www.fix-instruments.com

飞思仪表 (深圳) 有限公司
Fix Instruments (Shenzhen) Co., Ltd.

地址: 深圳市宝安区石岩街道罗租社区
罗租工业大道 2 号 B 栋中座二层

邮箱: sales@fix-instruments.com
电话: 0755-2359-1123

欢迎关注FixInst
官方公众号

**FIXINST**

IAS-PM01 系列

QUICK GUIDE

| 压缩空气分析套件-电能 © 快速使用指南 |



— 专注于压缩空气及流体的测量专家 —

确认装箱清单

为确保产品的顺利安装,请您在收到产品后 7个自然日内仔细检查装箱清单,如有异议,请务必在此期限内联系销售商

序号	名称	数量
1	IAS-PM01 专用防护箱	1
2	罗氏线圈	1
3	鳄鱼夹	1
4	4G 套件	1
5	封套 (安装指南+合格证)	1

产品功能示意图


确定安装地点

为了保持技术参数中所指明的精度,必须正确安装产品
安装产品前请确认现场受是否有足够的安装空间,确保安装完成后产品可以正常使用




警告!

产品无防爆功能,切勿安装在有防爆要求的场所,违规操作造成的任何后果制造商不予承担

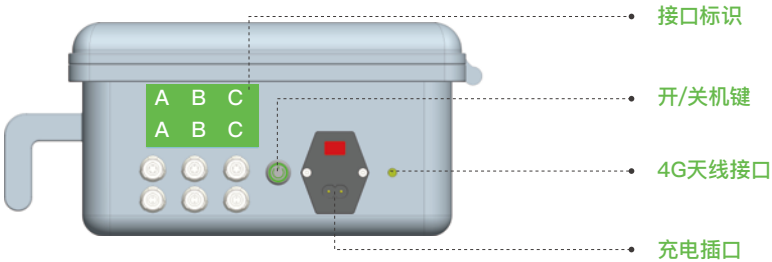

产品端接线示意图

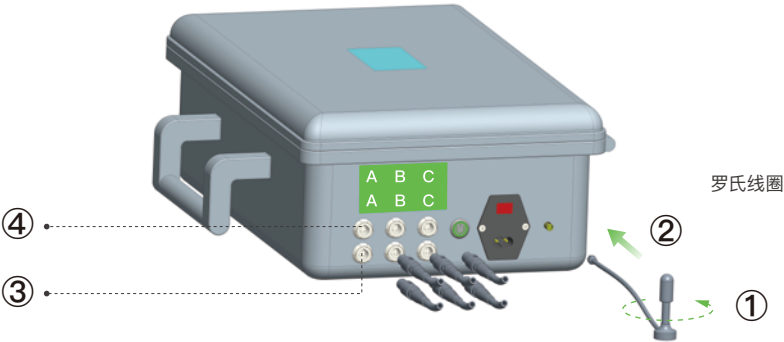

- ① 将 4G 天线拧入底座 (底座带磁吸, 可吸附到设备或管道)
- ② 将 4G 天线接线插入设备对应接口
- ③ 取出带一端鳄鱼夹 (V) 的连接线, 另一端按照线标上面的标号 (A、B、C) 依次接入对应接口 (插口带防呆功能, 如无法插入, 请检查是否插错, 切勿强行安装)
- ④ 取出一端带罗茨线圈 (I) 的连接线, 另一端按照线标上面的标号 (A、B、C) 依次接入对应接口 (插口带防呆功能, 如无法插入, 请检查是否插错, 切勿强行安装)

测量点接线示意图

三相三线不带 VT

