



F201x 系列

皮托管差压流量计

· 产品使用说明书 ·

版本号: 1.0.0

专注于压缩空气及气体的测量专家

更快 · 更准 · 更节能

前言

- 尊敬的客户，感谢您选择我们的产品。
- 本手册是关于产品的使用范围、各项功能、安装操作方法、故障处理、维护保养等的说明。
- 用户必须在使用设备前完整地阅读该操作手册，正确使用本产品。
- 在您阅读完成后，请妥善保管在便于取用的地方，以便下次操作时进行查阅

注意

- 对于因未仔细查看操作手册或违反此操作手册规定，擅自更改设备造成的损失，本公司概不负责且仪器保修将自动失效。
- 由于运输、设备性能或使用不当造成的间接损失，本公司不承担责任。
- 本公司不保证该设备在未描述上的适用性。
- 本手册内容我们力求正确无误，如有发现问题，欢迎与我们联系。
- 本手册内容未经允许禁止转载、复制、修改

目录

前言..... 3

注意..... 3

一、安全说明..... 5

 1.1 常规安全说明..... 5

 1.2 存储和运输安全..... 6

二、产品概述..... 7

 2.1 产品简介..... 7

 2.2 功能与特点..... 7

 2.3 技术参数..... 8

 2.4 量程范围..... 10

 2.5 订货参数..... 11

三、产品外形尺寸与安装..... 13

 3.1 外形尺寸（外形图）..... 13

 3.2 产品安装指南..... 14

 3.3 电气连接..... 17

四、功能设置..... 18

五、通讯协议..... 21

 5.1 通讯参数..... 21

 5.2 存储寄存器定义..... 21

 5.3 过程数据格式..... 21

 5.4 字节次序..... 21

 5.5 保持寄存器：过程数据地址表..... 22

 5.6 保持寄存器：通讯设置地址表..... 28

 5.7 线圈寄存器地址表..... 29

六、保修条款..... 30

一、安全说明

1.1 常规安全说明



警告！

压缩空气！

任何与急速漏气或压缩空气系统带压部分的接触都有可能导致重大损伤甚至死亡！

- 所有固定装置须保证牢固连接。
- 避免人员接触急速的漏气或仪器带压的部分。
- 进行维修维护作业时必须确保系统没有压力。



警告！

电源电压！

任何与产品通电部分的接触都可能导致重大损伤甚至死亡。

- 考虑所有电气安装相关的规定。
 - 电路带电时，请不要在易爆环境中拆除流量计外壳。
 - 进行维修维护作业时必须断开任何电源连接。
 - 系统中任何电气工作只允许授权人员进行操作。
-

**注意！****操作条件许可范围**

请查看许可的操作条件，任何超出这些许可的操作都有可能导致设备故障，甚至损坏仪器或整个系统。

- 请在准备阶段和安装使用过程中查看国家法规、备注。
- 爆炸区域内禁止使用该产品。
- 请确保产品运行在允许的工作条件范围内。
- 不要超出或者低于允许的存储/工作温度和压力。
- 禁止擅自分解产品。
- 在工作状态中请使用正确且合适的工具。

**注意！****仪器故障会影响测量值！**

产品必须正确安装并定期维护，否则将导致错误的测量数据从而导致错误的测量结果。

- 产品出现故障请停止使用并联系相关技术人员处理无误后再使用
-

1.2 存储和运输安全

- 确保本产品的运输温度为 **-30 ... +70 °C** 之间。
- 存储和运输时建议使用产品原包装。
- 请确保产品的存储温度在 **0 ... +40 °C** 之间。
- 避免阳光和紫外线的照射。
- 存储的湿度必须是 **< 70%** 且无冷凝水。

二、 产品概述

2.1 产品简介

F201x 皮托管流量计基于差压原理设计和运行，内置温压补偿，可对温度及压力进行实时检测，可在很大程度上避免高频规则振动的影响。F201x 可同步输出温度、压力、流速、流量和累积量，降低成本和现场工作难度。在线自动校准功能，自动温压补偿，自动压力零点校准。全隔离电气设计，信号更加稳定可靠，抗干扰能力强。

2.2 功能与特点

- ✓ 适用于脏、湿空气测量，例如：空压机出口。
- ✓ 极高灵敏度，气体测量下限可达 5 Nm/s。
- ✓ 双向流量测量。
- ✓ 集成压力和温度传感器，可实时监测流体压力及温度。
- ✓ 全隔离的电气结构，彻底滤除干扰。
- ✓ 带电容触摸的 2.8"IPS 超宽视角液晶屏。
- ✓ 无可动部件，压力损失小。
- ✓ 带数据记录功能，10,000,000 个记录点。
- ✓ 带蓝牙功能，可无线进行传感器配置及数据传输。
- ✓ 标配 Modbus RTU (RS485) 接口及 4~20 Ma 电流 / 脉冲输出。
- ✓ 插入式，可适配不同管径，通过 1 / 2" 球阀可不停气带压安装。

2.3 技术参数

流量测量	
测量范围	5 ... 300 Nm/s
精度等级	±(1.5 %RD + 0.3 %FS) [1 %RD 精度可选]
介质	干 / 湿空气及非腐蚀性气体
参考条件	20 °C, 1 bar(a) - ISO 1217 （可编辑）
压力测量	
测量范围	0 ... 1.7 MPa(a)
测量精度	±0.5 %FS
温度测量	
测量范围	-40 ... +150 °C
测量精度	±0.5 °C
输出	
模拟输出（标配）	4 ... 20 mA（隔离） / 脉冲输出（累积量）
数字输出（标配）	Modbus RTU (RS485)
无线输出	蓝牙连接（标配）, Lora（选配）
连接器	2 × 5 pin M12, Female
电源	
正常测量	18 ... 30VDC / 6.5W @ 24VDC
预热阶段	18 ... 30VDC / 24W @ 24VDC
显示 / 数据记录	
显示	带电容触摸的 2.8" IPS 超宽视角液晶屏
数据记录	10,000,000 个记录点

工作环境	
工作温度	-20 ... +60 °C
介质温度	-40 ... +150 °C
工作压力	0 ... 1.7 MPa(a)
其他	
工艺连接	G1/2" (ISO 228-1)
电磁兼容	符合 IEC 61326-1

2.4 量程范围

英寸 (Inch)	公称直径 DN	ID (mm)	最低流量 (Nm ³ /h)	最大流量 (Nm ³ /h)
1	25	25	8.8	530
1 ^{1/4}	32	32	14.5	868
1 ^{1/2}	40	40	22.6	1357
2	50	50	35.3	2120
2 ^{1/2}	65	65	59.7	3583
3	80	80	90.5	5428
4	100	100	141.4	8482
5	125	125	220.9	13253
6	150	150	318.1	19085
8	200	200	565.5	33929
10	250	250	883.6	53014
12	300	300	1272.3	76340

*更多管径尺寸的流量范围请咨询销售人员

2.5 订货参数


F201x 订货信息一览表

型号	工艺 连接	数字 输出	模拟 输出	流量范围	气体类型	精度	显示器	产品描述
F201A-W								皮托管流量计，插入式，250 mm 杆长 (适用管径 DN25-DN300)
F201B-W								皮托管流量计，插入式，400 mm 杆长 (适用管径 DN25-DN600)
F201A-W-B								皮托管流量计，插入式，250 mm 杆长 双向流量测量 (适用管径 DN25-DN300)
F201B-W-B								皮托管流量计，插入式，400 mm 杆长 双向流量测量 (适用管径 DN25-DN600)
	1							ISO G1/2" Screw
		1						Modbus RTU (RS485)
			1					4 ... 20 mA + 脉冲输出
				V0205 0001				流量范围 (5~300 Nm/s)
					V0202 0001			Air
					V0202 0002			Oxygen (O ₂)
					V0202 0003			Nitrogen(N ₂)

型号	工艺 连接	数字 输出	模拟 输出	流量范围	气体类型	精度	显示器	产品描述
					V0202 0004			Hydrogen (H ₂), Real Gas Calibration
					V0202 0005			Nitrous Oxide (N ₂ O)
					V0202 0006			Carbon Dioxide (CO ₂)
					V0202 0007			Natural Gas (NG)
					V0202 0008			Argon (Ar)
					V0202 0009			Helium (He), Real Gas Calibration
					V0202 0010			Other Specified Gases (Specify Gas or Gas Mix)
						V0204 0001		标准精度校准 ±(1.5% RD + 0.3% FS)
						V0204 0002		高精度校准 ±(1% RD + 0.3% FS)
							S0105 0001	带电容触摸的 2.8" IPS 超宽视角液晶屏 + 数据记录功能

三、 产品外形尺寸与安装

3.1 外形尺寸（外形图）

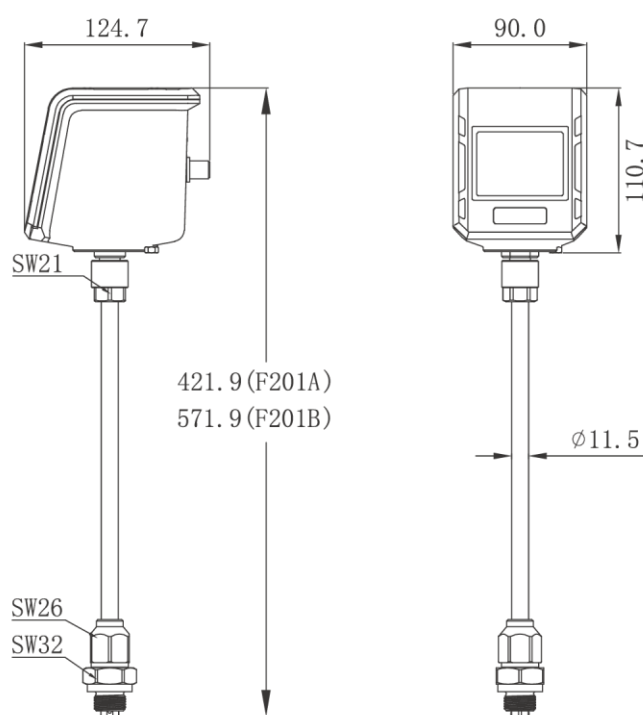

F201x 产品外形尺寸图

3.2 产品安装指南

- 安装场所和环境选择

为达到额定检测精度，除仪表本体外，安装环境也须满足技术要求。

测点须位于长直管段，并满足上下游最低长度要求（具体数据见后）。将传感器置于安装点管道中心位置，测量方向与气流方向保持一致。

任何毛刺、接缝、弯道或其它障碍物，都可能造成逆向或正向涡流，导致数据失真。

F201x 皮托管流量计仅供室内使用。如需安装在室外，需避免阳光直射或雨雪淋袭。

注意：

虽然少量液态水通常不会对皮托管流量计产生影响，但过多的液态水或其它杂物仍有可能会堵塞取压管，干扰 F201x 运行。要求安装时仪表和重力方向夹角 $\leq 45^\circ$ ，尽量避免过多液体进入并堵塞取压管。最佳选择是沿重力方向安装，如取样管被堵塞影响测量，且杂质位于取压管中下部，可尝试拆出后将取压管清理干净，即可恢复使用。否则，建议寄回 FixInst 售后处理，以免造成损坏。

F211x 安装步骤

- 测量点选择

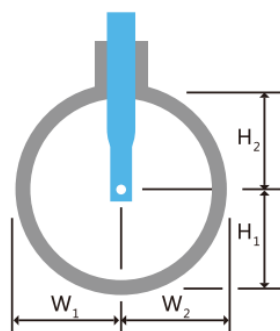


图 3-4 测量点选择示意图

上图中， $H_1=H_2=W_1=W_2=1/2D$

其中 W_1 与 W_2 依靠焊接短丝头垂直于管道切面来控制， H_1 与 H_2 依靠插入深度（计算、测量和观察标尺并调整）来控制。

- 直管段要求

为了准确测量，流量计的上、下游必须留有足够的直管段，上游不应有影响流体流速分布的部件，图 3-1 为各种管路情况下流量计前、后直管段最小长度要求。

(*DN: 管道内径)

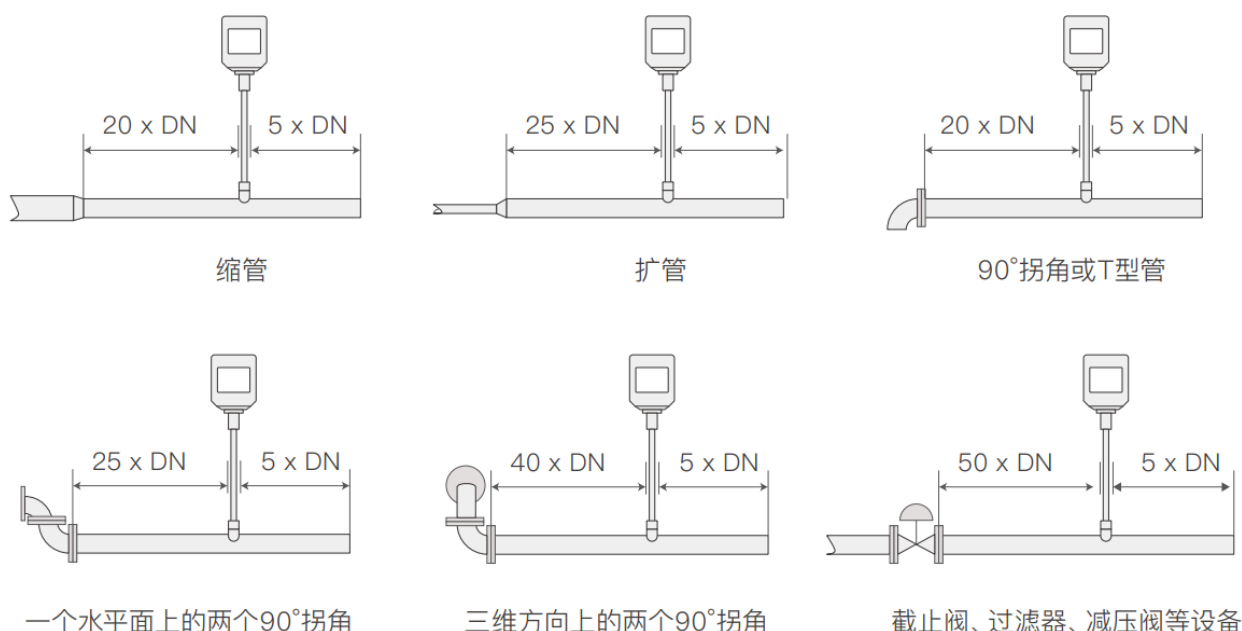


图 3-5 直管段安装要求

- 电源准备

F201x 皮托管流量计采用 24 VDC 供电，M12-5 航空插头连接方式。如现场不具备 DC 24V 5W 的供电条件，则需选择专用的电源转换器，请联系本公司购买。

请将 M12-5 插头的连接线缆预留适当长度，避免施加应力。

- 焊接丝头

丝头规格要求为国标攻丝管，G $\frac{1}{2}$ "公螺纹(应与球阀配套)。焊接完成后，丝头外端面到管道的距离应 ≤ 30 mm。丝头固定后即无法取下，因此请避免采用薄壁或受挤压缩径的丝头。焊接时可采用延长或辅助夹具，保证丝头垂直度。焊接时需避免焊穿管道，否则内壁毛刺会导致湍流，影响检测精度。焊缝应均匀牢固无气孔。

- 开孔

钻孔时请确保管道充分释压，否则须采用专用带压开孔器，请联系本公司采购。开孔孔径要求 $\Phi > 13.2$ mm，光滑无毛刺，与丝头共圆心。

• 安装球阀

建议采用球阀方式安装。此安装方式将使 F211 具备带压拆装功能，更有利于临时检测、后期标定和维修。请使用不锈钢两片式全通径球阀，内径 > 13.2 mm。请务必选用 G $\frac{1}{2}$ " 螺纹，否则将导致流量计无法牢固连接，或损坏连接器螺纹。连接球阀时，请确保阀门打开后，手柄指向流量计表头方向。

注意：

如采用无球阀安装方式，F201x 可正常使用，但将导致无法带压拆卸，影响重新校准或维修期间的安装接口封堵。当然，也不具备带压安装功能。

• 安装方法

请适当松开流量计锁紧螺母，将锁紧螺母和连接器推至取样孔侧。F201x 采用端面密封。将 O 型圈置于连接器端面，连接并旋紧连接器，使连接器和阀门端面压紧 O 型圈，即可获得良好密封。请保持流量计箭头与气体流向一致。

使用外径尺，测量管道外径 OD。使用直尺，测量管道与连接器下端面距离 Y，
计算，得到安装高度数据

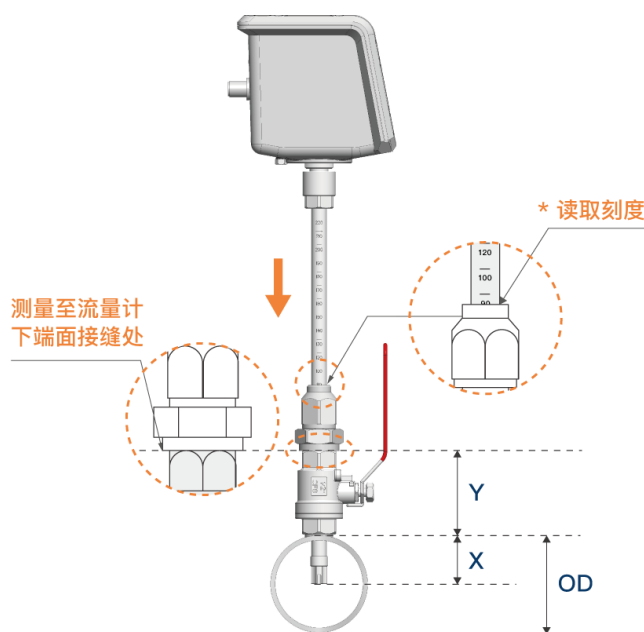


图 3-6 直管段安装要求

$$\text{Installation Height (IH)} = \frac{1}{2}\text{OD} + Y(\text{mm})$$

打开阀门，将 F201x 缓慢下推，并在锁紧螺母上沿读取插入刻度，使得插入刻度等于上述计算的 IH 值。考虑到锁紧螺母锁紧时将继续下降约 1 mm，所以调整插入深度时应多插入对应高度。

使用方向调节尺进行微调，保持与气流方向一致，偏差角度应 $\leq 2^\circ$ 。方向调节尺在随流量计产品附带 1-2 把。

复查插入深度和方向，确保无误后拧紧锁紧螺母（20~30 Nm）。

3.3 电气连接

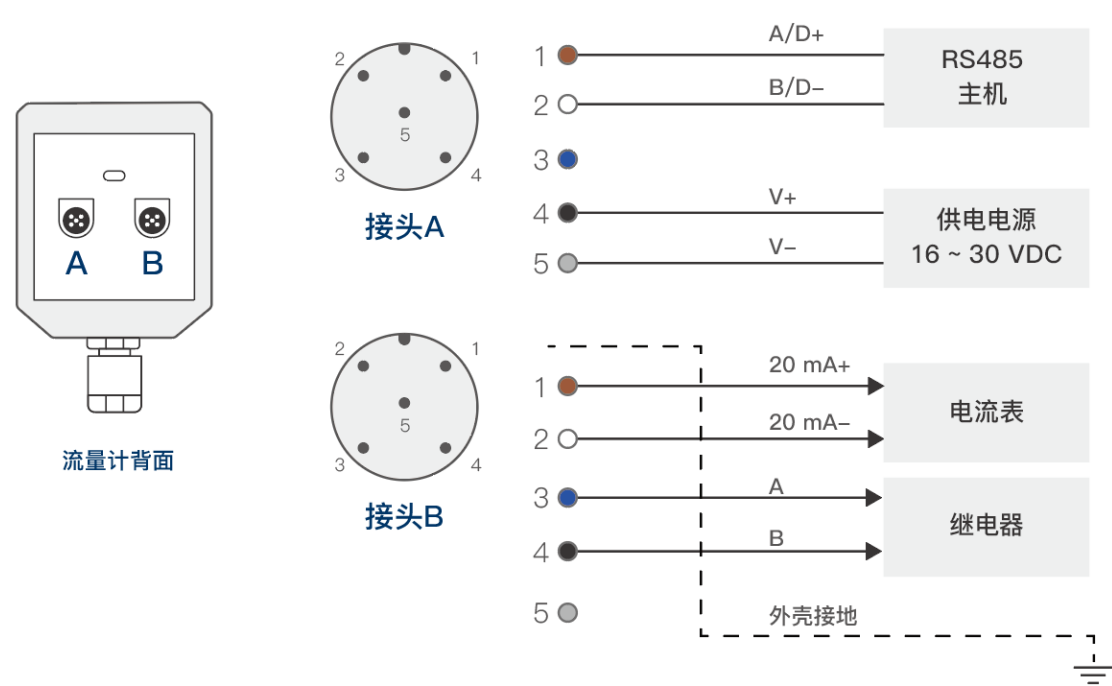


图 3-7 流量计线路连接示意图

M12 引脚线定义

电气接线	引脚 1	引脚 2	引脚 3	引脚 4	引脚 5
接头 A	RS485 A/D+	RS485 B/D-	N/A	电源 V+	电源 V-
接头 A	20 mA+	20 mA+	继电器 A	继电器 B	N/A
接线颜色	棕色	白色	蓝色	黑色	灰色

四、功能设置

流量计通电后，即开始按照记忆设定值自动运行。

- 开机界面



图 4-1 F201x 开机界面

- 显示界面

显示界面默认页显示流量检测内容，分别为标况瞬时流量、标况瞬时流速和标况累积量。通过左滑触摸操作，可切换为更多数据显示页，可查看更多参数，包括温度、压力和密度。如有需要，还可设置显示工况参数，包括工况瞬时流量、工况瞬时流速和工况累积量。


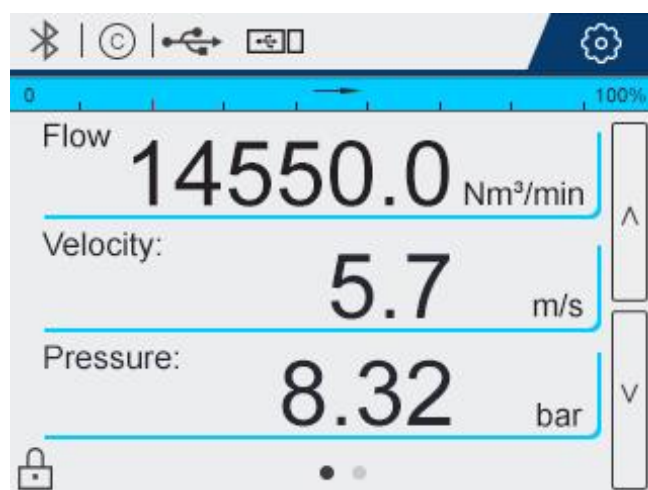


图 4-2 F201x 主要交互界面

F201x 皮托管流量计采用 IPS 触摸屏，并采用所见即所得的操作方式，简单易懂。运行中可随时解锁并单击设置按钮，进入设置界面。

• 设置菜单

说明：因软件升级，菜单及内容可能更新，具体以实际情况为准或咨询 FixInst 技术支持人员。

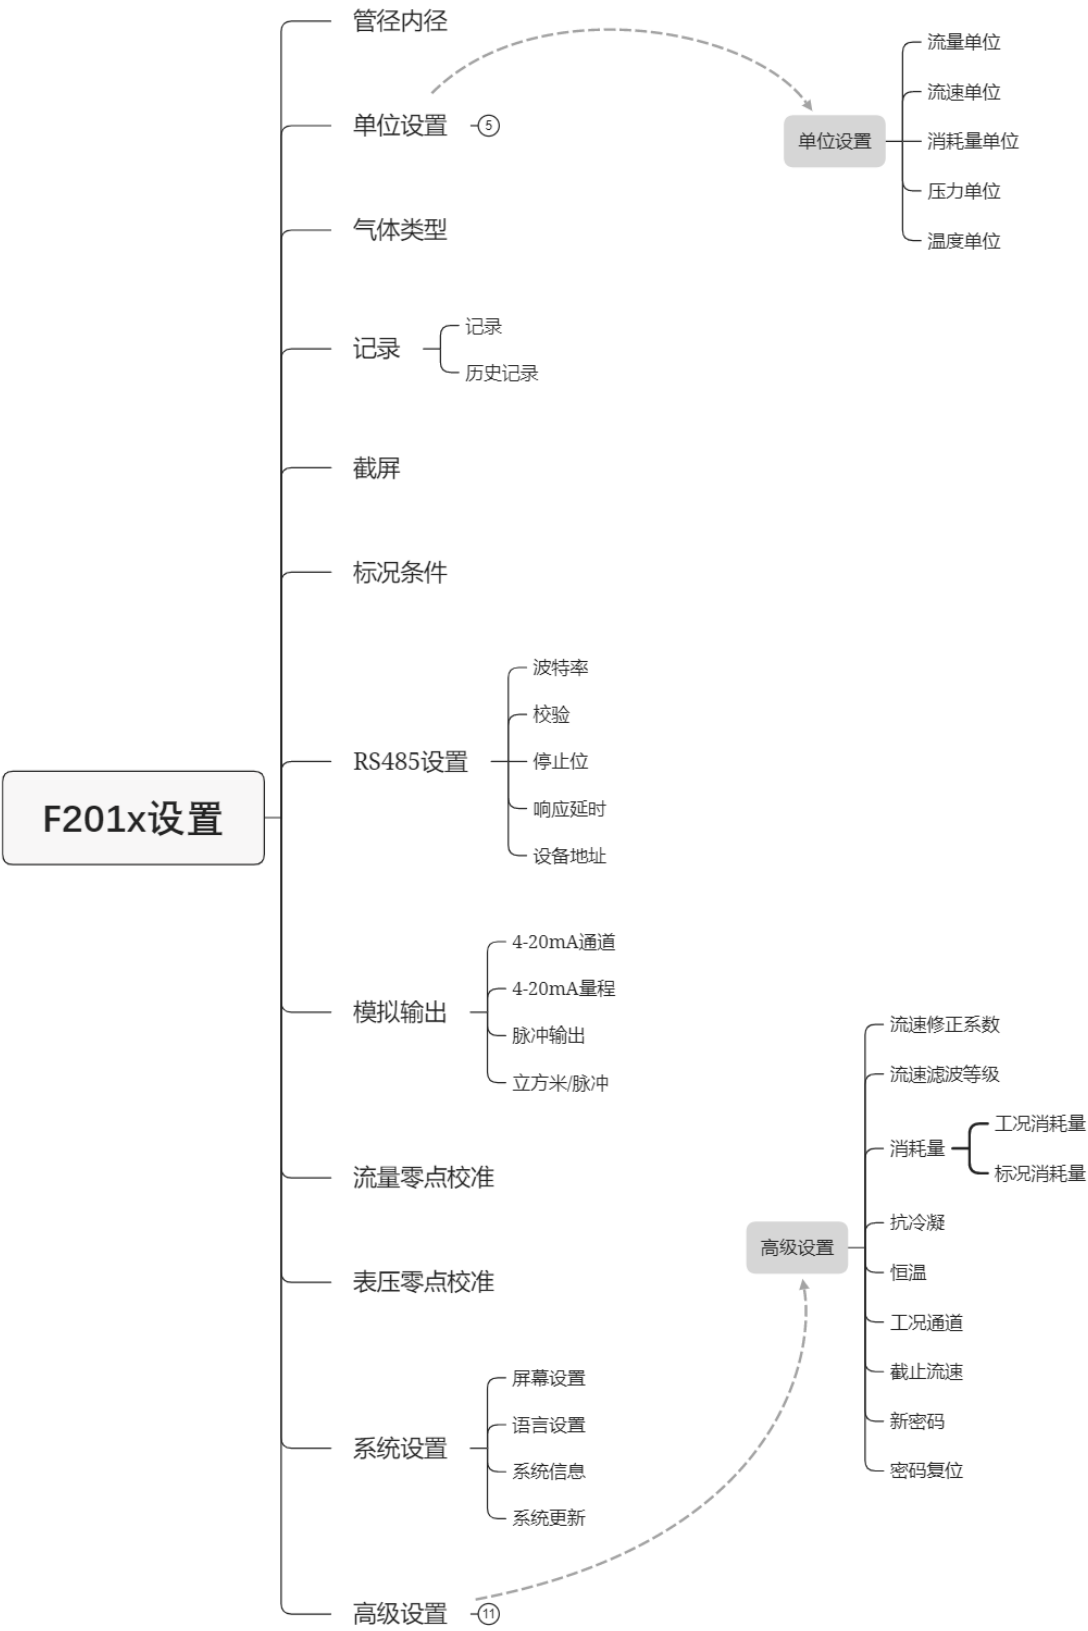

信号输出

- RS485 通信

F201x 皮托管流量计支持 RS485 通信，相关通讯协议详见第六章。

- 模拟量输出

F211x & F212x 系列流量计标配 4 ~ 20 mA 输出流速。其中 4 mA 对应 0 Nm/s，20 mA 对应该型号最高流速（标准型具体数值请见“量程范围”，非标型号以出厂 Calibration Certificate File 为准）。

输出通道可通过表头显示模块或服务套件或 RS485 修改。

采用内置记录仪记录或输出后，可根据流速和管径计算瞬时流量。如采用外置记录仪，可将 4 ~ 20 mA 工程量直接设置为 0 和最大流速，即可获得流速的记录；也可设置为 0 和对应的最大瞬时流量，即可获得瞬时流量的记录。

$$\text{瞬时流量 Flow (Nm}^3\text{/min)} = \pi \times (\frac{1}{2}\text{内径 OD})^2 \text{ (mm)} \times \text{流速 Velocity (Nm/s)} \times 10^{-6} \times 60$$

- 脉冲输出

F201x 皮托管流量计每计量到 1 单位流量（可根据需要在 1~999 m³ 内选择单位流量），即发出一个与输入电压幅值相等的脉冲信号。

五、通讯协议

5.1 通讯参数

出厂设置参数如下:
地址: 1
波特率: 9600
数据长度: 8, 奇偶校验位: None, 停止位: 1
响应超时: 1 秒
响应延时: 0 毫秒
帧间隔: 7 个字符

5.2 存储寄存器定义

- 逻辑通道、数据和保持寄存器
- 可用 MODBUS 指令 0x03 读取保持寄存器数据
 - 可用 MODBUS 指令 0x06 写入单个保持寄存器, 0x10 连续写入多个保持寄存器
 - 可用指令 0x05 写入线圈寄存器

5.3 过程数据格式

- 支持两种数据类型: IEEE 754 浮点数和无符号整型.
- 浮点数格式

数值 (带小数的)	IEEE 754 浮点数	寄存器 N		寄存器 N + 1	
		高位	低位	高位	低位
123.4	0x42F6CCCD	0xCC	0xCD	0x42	0xF6

无符号整型

数值 (十进制)	IEEE 754 浮点数	寄存器 N		寄存器 N + 1	
		高位	低位	高位	低位
123456789	0x075BCD15	0xCD	0x15	0x07	0x5B

5.4 字节次序

- 数据的格式是小字节续, 先传输最低有效位.
- 32 位: CD AB
- 64 位: GH EF CD AB

5.5 保持寄存器：过程数据地址表

寄存器地址	数据类型	字节长度	数据	单位	读/写	适用流量计型号
0	FLOAT_L	4	标况流量		R	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
2	FLOAT_L	4	标况流速		R	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
4	DOUBLE_L	8	累计标况流量		R W: 写“0”清除数值	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
8	FLOAT_L	4	温度		R	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
10	FLOAT_L	4	表压		R	F20x 皮托管压差流量计 F231x-V 涡街流量计
12	FLOAT_L	4	工况流量		R	F20x 皮托管压差流量计 F231x-V 涡街流量计
14	FLOAT_L	4	工况流速		R	F20x 皮托管压差流量计 F231x-V 涡街流量计
16	DOUBLE_L	8	累计工况流量		R W: 写“0”清除数值	F20x 皮托管压差流量计 F231x-V 涡街流量计
20	FLOAT_L	4	介质密度		R	F20x 皮托管压差流量计 F231x-V 涡街流量计
22	UNSIGNED LONG	4	累计标况流量 (4 位字节)		R W: 写“0”清除数值	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
24	UNSIGNED LONG	4	累计工况流量 (4 位字节)		R W: 写“0”清除数值	F20x 皮托管压差流量计 F231x-V 涡街流量计
26	UNSIGNED INT	2	气体介质类型		R/W: 0: 空气 (默认) 1: 氧气 (O2) 2: 氮气 (N2)	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计

寄存器地址	数据类型	字节长度	数据	单位	读/写	适用流量计型号
					3: 氢气 (H2) 4: 一氧化碳 (CO) 5: 二氧化碳 (CO2) 6: 六氟化硫 (SF6) 7: 氩气 (Ar) 8: 氦气 (He) 9: 一氧化二氮 (N2O) 10: 甲烷 (CH4) 11: 乙烷 (C2H6) 12: 丙烷 (C3H8) 13: 丁烷 (C4H10)	
27	UNSIGNED INT	2	流量单位		R/W: 0: m³/h (Nm³/h) 1: m³/min (Nm³/min) (默认) 2: m³/s (Nm³/s) 3: l/min (Nl/min) 4: l/s (Nl/s) 5: cfm (Ncfm) 6: kg/h 7: kg/min 8: kg/s	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
28	UNSIGNED INT	2	流速单位		R/W: 0: m/s (Nm/s) (默认) 1: ft/s (Nft/s)	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计

寄存器地址	数据类型	字节长度	数据	单位	读/写	适用流量计型号
29	UNSIGNED INT	2	累计流量单位		R/W: 0: m/s (Nm/s) (默认) 1: ft/s (Nft/s) 2: kg	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
30	UNSIGNED INT	2	温度单位		R/W: 0: °C (默认) 1: °F	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
31	UNSIGNED INT	2	压力单位		R/W: 0: Pa 1: hPa 2: kPa (默认) 3: MPa 4: mbar 5: bar 6: psi	F20x 皮托管压差流量计 F231x-V 涡街流量计
32	FLOAT_L	4	管道内径	mm	R/W	F20x 皮托管压差流量计 F231x-V 涡街流量计
34	FLOAT_L	4	标况温度	°C	R/W: 默认值为 20 °C	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
36	FLOAT_L	4	标况压力	kPa	R/W: 默认值为 100 kPa	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
38	UNSIGNED INT	2	滤波等级		R/W: (默认值为 5) F20x / F21x / F22x: 1 ~ 255 F23X-V: 1 ~ 32	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
39	FLOAT_L	4	① 流量因子		R/W: 流量因子不可设为小于 0 的值, 默认值为 1	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计

寄存器地址	数据类型	字节长度	数据	单位	读/写	适用流量计型号
41	FLOAT_L	4	当前大气压	kPa	R/W: 默认值为 101.325 kPa 用于修正表压	F20x 皮托管压差流量计 F231x-V 涡街流量计
43	UNSIGNED INT	2	自动排水		R/W: 0: 关闭 1: 打开 (默认)	F20x 皮托管压差流量计
56	DOUBLE_L	8	反向累计标况流量		R W: 写 “0” 清除累计流量	F20x 皮托管压差流量计
60	DOUBLE_L	8	反向累计工况流量		R W: 写 “0” 清除累计流量	F20x 皮托管压差流量计
64	UNSIGNED LONG	4	反向累计标况流量 (4 字节数据类型)		R W: 写 “0” 清除累计流量	F20x 皮托管压差流量计
66	UNSIGNED LONG	4	反向累计工况流量 (4 字节数据类型)		R W: 写 “0” 清除累计流量	F20x 皮托管压差流量计
70	FLOAT_L	4	截止流速	m/s Nm/s	R/W: (默认值为 0) 截止流速不可设为负值 F23x-V: 工况流速 F20x / F21x / F22x: 标况流速	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
72	FLOAT_L	4	② 涡街仪表系数	P/L	R/W	F231x-V 涡街流量计
74	FLOAT_L	4	② 涡街频率	Hz	R	F231x-V 涡街流量计

寄存器地址	数据类型	字节长度	数据	单位	读/写	适用流量计型号
101	UNSIGNED INT	2	软件版本		R	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
102	UNSIGNED INT	2	硬件版本		R	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计
103	DOUBLE_L	8	产品序列号		R	F20x 皮托管压差流量计 F21x / F22x 热式质量流量计 F231x-V 涡街流量计

备注：**① 流量因子用于修正流量示值：**

$$\text{流量示值} = \text{流量测量值} \times \text{流量因子}$$

例如：流量测量值 = $50 \text{ Nm}^3/\text{min}$

流量因子 = 0.8

则 流量示值 = $50 \times 0.8 = 40 \text{ Nm}^3/\text{min}$

② 涡街频率输出/仪表系数 = 工况流量 (L/s)**写入命令例子如下：**

浮点数 $v=123.4$ 其对应的十六进制 0x42F6 CCCD。将此值写入设备地址 1，保持寄存器地址 36（压力单点校准偏移量）

发送 Modbus 命令：01 10 0024 0002 04 CCCD 42F6 EE0D

01: 设备地址

10: 功能码 16 的十六进制

0024: 保持寄存器地址 36 的十六进制

0002: 需要写的保持寄存器数量

04: 保持寄存器字节数 (0x42F6 CCCD 共 4 个字节)

CCCD: 浮点数低 16 位

42F6: 浮点数高 16 位

EE0D: CRC

设备应答：01 10 0024 0002 01C3

01: 设备地址

10: 功能码 16 的十六进制

0024: 保持寄存器地址 36 的十六进制

0002: 已经写入的保持寄存器数量

01C3: CRC

5.6 保持寄存器：通讯设置地址表

寄存器地址	数据类型	字节长度	单位	内容	默认	读/写
50	UNSIGNED INT	2		设备重启（写入 1 重启设备）		只写
51	UNSIGNED INT	2		设备地址（1…247）	1	读/写
52	UNSIGNED INT	2	bps	波特率： 12 = 1200 位/秒 24 = 2400 位/秒 48 = 4800 位/秒 96 = 9600 位/秒 144 = 14400 位/秒 192 = 19200 位/秒 384 = 38400 位/秒 560 = 56000 位/秒 576 = 57600 位/秒 1152 = 115200 位/秒	96	读/写
53	UNSIGNED INT	2		奇偶校验位 0 = 无 1 = 奇校验 2 = 偶校验	0	读/写
54	UNSIGNED INT	2		停止位 1: 1 位 2: 2 位	1	读/写
55	UNSIGNED INT	2	ms	响应超时： 0…255 毫秒 1 毫秒/步 值的范围：0…255	0	读/写

备注：
这些设定只有在向寄存器 50 写入 1 才会生效，然后 Modbus 主机需改变自身的通讯设定来和从机通讯。

5.7 线圈寄存器地址表

线圈地址	数据类型	字节长度	单位	内容	默认	读/写
0	UNSIGNED INT	2		重启 Modbus 通讯 写：0x0000 = 无作用 0xff00 = 重启 读：总是为 0	0	读/写

六、保修条款

FixInst 全系列仪表，享受自发货之日起 12 个月质保。保修范围内将由 FixInst 承担零件费和人工费，客户承担包装、运输和保险费。

如仪表使用异常，请准备好相关资料，包括准确的照片、视频、数据和情况描述，并尽快联系 FixInst 售后服务部。

违反操作手册规定、非正常损伤（包括人为损坏）、未经授权而拆开仪表、序列号被更改/破坏或去掉等，将使保修立即失效。但客户按照操作手册明确要求进行的维护不影响保修。

如在保修期内同时产生保修范围内的服务和保修范围外的服务，包括但不限于必要的维修、调节或翻新，则额外的服务部分是收费的。

FixInst 不对除 FixInst 仪表本体外的任何损失负责。

注：电池、电源和新更换的零部件保修期为 3 个月。

专注于压缩空气及气体的
测量专家

飞思仪表（深圳）有限公司
Fix Instruments (Shenzhen) Co. , Ltd.

地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区
罗租工业大道 2 号 B 栋中座二层

邮箱：sales@fix-instruments.com

电话：0755-2359-1123

